


UDT-812A- 12

自动溶出仪

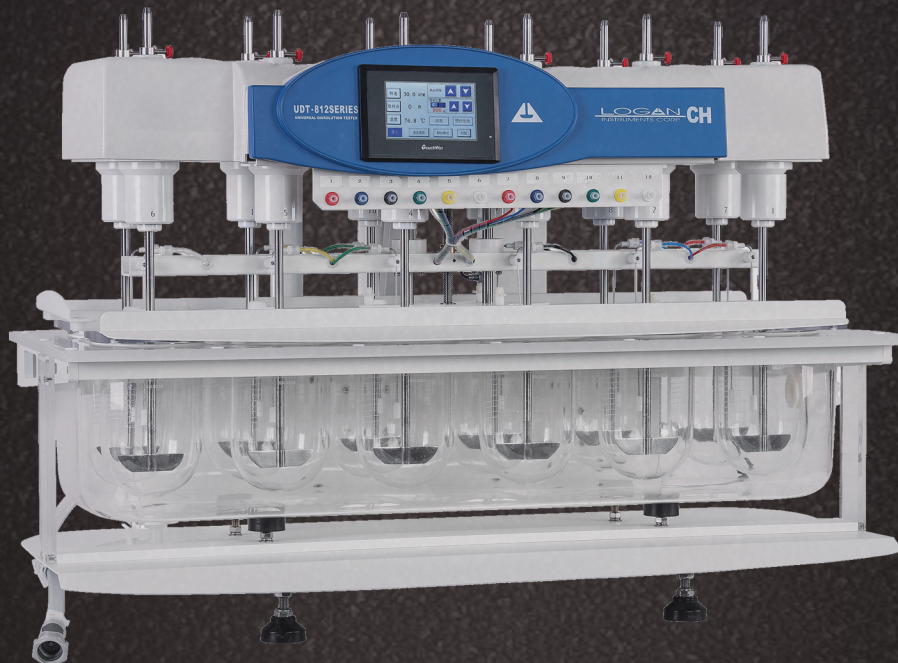

UDT-812A-12自动溶出仪是符合USP标准的最新的溶出测试仪器。本溶出仪操作简单且可持续运行，其中12个溶出杯可用于测试样品，另配备1个2升的夹层杯用于同温补液。

内置加热器大大节约了空间，取样针的位置可以根据不同体积的溶媒自动调整，桨叶和转篮的高度也可自动设置。无摆动设计和自动校正设计确保所有药品在准确转速和相同速度下溶解。

溶出杯平台具有耐酸性，平台高度可调整，可保证水槽密闭性防止水汽蒸发。

UDT-812A-12配套使用的可选配件有：自动取样架-用于连接UV系统、HPLC系统，也可用注射器手动取样；投药盘；控制/校准/验证软件包；外接打印机。


UDT-812A-12的性能高于USP、BP、EP和JP的标准要求。

LOGAN
INSTRUMENTS CORP.

中国销售中心



LCD触摸屏便捷控制速度，温度和
时间



自动校准溶出杯中心，自动
校正速度和温度控制系统



2/3种转速区域（备选）




电动自动升降，垂直升降属性
确保转轴和溶出杯的中心一致
性




实现与UV、HPLC、光纤系统联
机在线分析



内置水浴加热系统，节省
空间



坚固的卡盘设计确保转轴无摆
动



一体成型水箱，预留摄像记
录系统

规格参数

UDT-812A-12溶出仪

溶出杯位置数量	12个
转速范围	25 - 250rpm $\pm$ 1rpm
控温范围	25 - 45°C $\pm$ 0.1°C
主轴直径	3/8" (9.5mm)
水槽材质	塑性透明合成材料
加热功率	1200W
重量	44lbs (20kg)
电压	110-120V, 50/60Hz 220-240V, 50/60Hz